

Figura 4.1. Colágeno liofilizado tras el proceso de ultrafiltración, listo para ser grafitizado.



Figura 4.2. Portamuestras para la medida por AMS junto a una muestra tipo.



Figura 4.3. MICADAS, sistema de detección del radiocarbono en el Centro Nacional de Aceleradores.

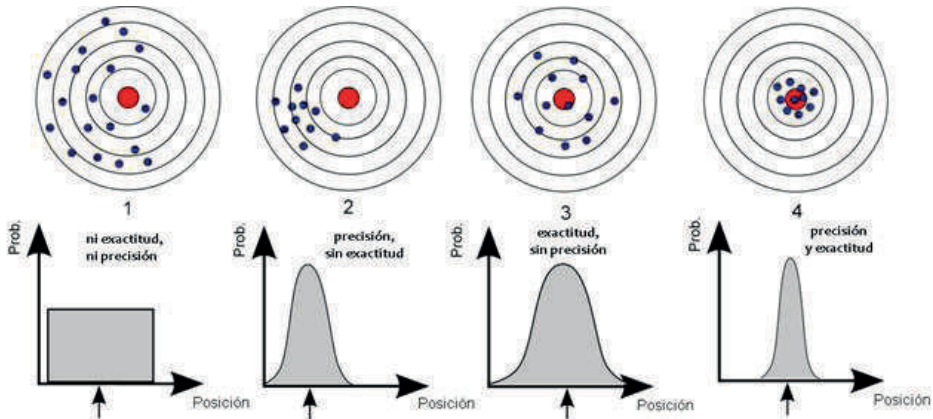


Figura 5.1. Esquema indicativo del significado de la precisión y la exactitud en una medida.